


2023年デバイス成績

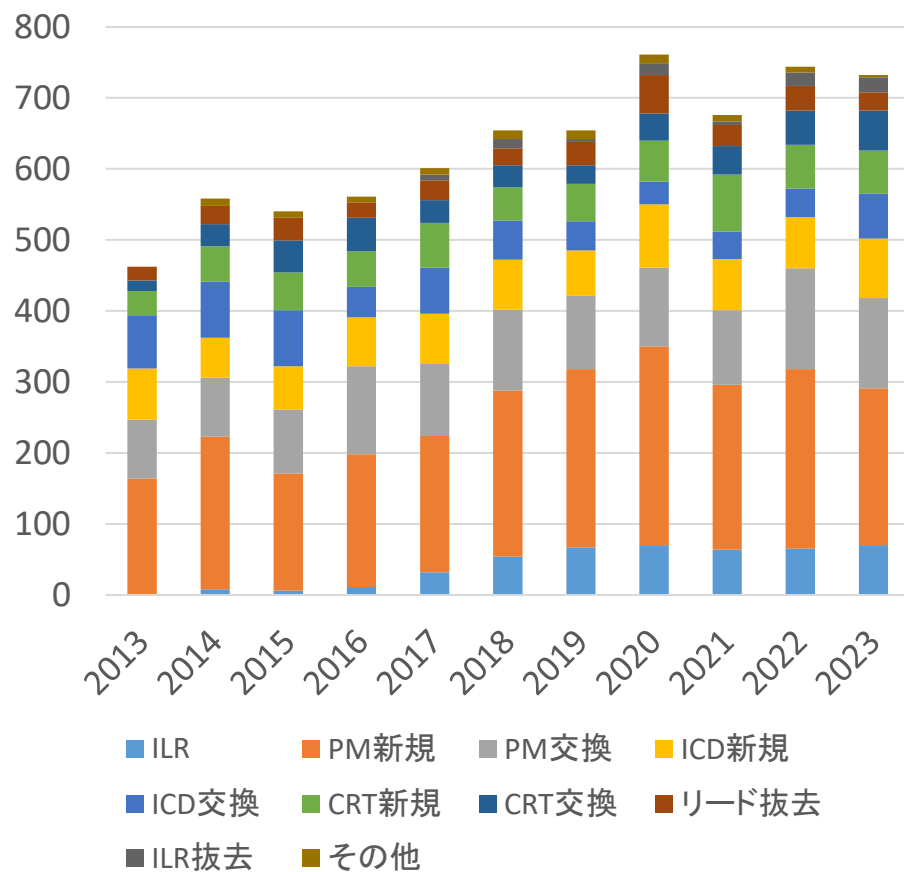

	新規	交換
PM	221	127
CRT-P	17	11
ILR	70	抜去21
ICD	84	63
CRT-D	44	45
リード抜去(S-ICD含む)	26	
その他抜去部皮膚縫合含む	3	計 732件

総手術件数(732件)は12例減少(2022年744件)
 PM新規・抜去減少、CRT横ばい、ICDは増加
 純粋な総デバイス手術数は682件(2022年682件)
 合併症は19件3%と横ばい(2022年20件3%)

内科673件(デバイス+抜去+その他) 合併症:19件

リード位置移動再留置:3例
 リード閾値上昇保存的加療:1例
 リードレス閾値上昇抜去・TV-PM再留置:1例
 冠静脈解離:3例
 冠静脈血栓:1例
 感染:4例(感染抜去2, SICD保存的加療2)
 創部離開:1例
 リードレス心損傷:1例
 抜去時鎖骨下静脈損傷:1例
 上大静脈損傷:1例
 気胸:1例
 G交換後lead不全:1例